

参数

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 容量      | 100L               |
| 额定容量L   | 100                |
| 额定功率    | 20-25              |
| 额定转速rpm | 48                 |
| 额定高度h   | 12-16              |
| 额定功率kw  | 5.5                |
| 额定功率kw  | 2.5                |
| 重量kg    | 1050               |
| 尺寸mm    | 1200 * 1150 * 1050 |

说明

1. 本设备为实验室专用设备，使用时请严格按照操作规程进行操作。

2. 安全

2.1 使用前请仔细阅读说明书。



2.2 使用过程中请勿触摸旋转部件。

3. 维护

3.1 定期检查设备运行状态，发现问题及时处理。

3.2 定期对设备进行清洁和保养。

4. 其他

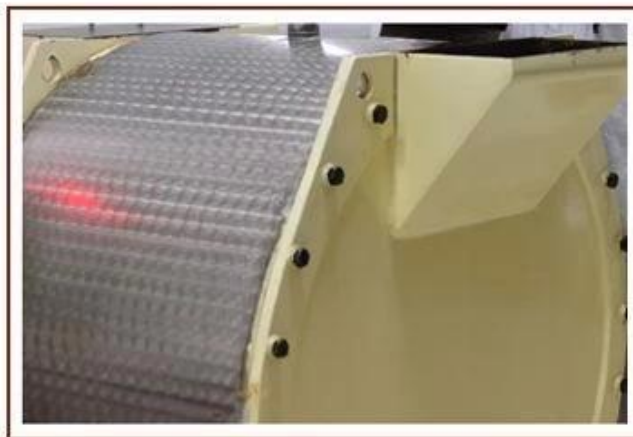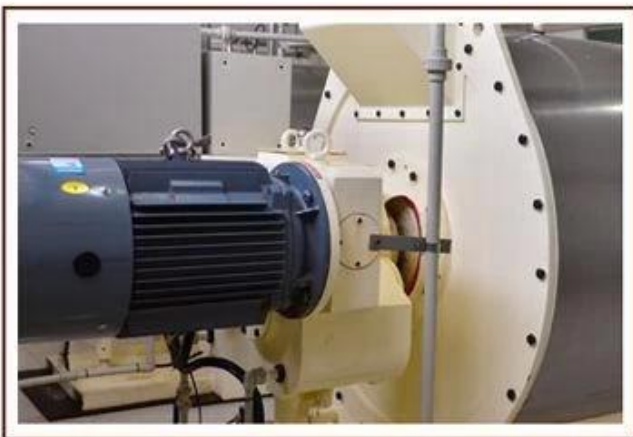

□□







**SUZHOU ASIA-EUROPE BRIDGE  
ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.**

□□□

| CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                              |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p><b>CE</b></p> <p>China Quality Certification Center<br/>CERTIFICATE OF CONFORMITY</p> <p>Product: ...<br/>Model: ...<br/>Standard: ...<br/>This is to certify that the above product conforms to the requirements of the standard ...</p> <p><b>CE</b></p> | <p><b>CE</b></p> <p>WEN INJECTION &amp; CERTIFICATION CO. LIMITED</p> <p>CERTIFICATE OF CONFORMITY</p> <p>No. ...<br/>Product: ...<br/>Model: ...<br/>Standard: ...<br/>This is to certify that the above product conforms to the requirements of the standard ...</p> <p><b>CE</b></p> | <p><b>Patent Certificate</b></p> <p>实用新型专利证书</p> <p>...</p> | <p><b>ISO</b></p> <p>CERTIFICATE</p> <p>Shanghai Zhongshan Certification Center</p> <p>...</p> <p><b>ANAB</b> <b>IAP</b></p> | <p><b>ISO</b></p> <p>ZDHY</p> <p>...</p> <p><b>IAP</b></p> |
| Equipment variety complete, reasonable price !                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | Excellent quality assurance, customer service !                                                                              |                                                            |

□□□□□

